

КОПИЯ

КОПИЯ
С КОПИИ



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

FEDERAL SERVICE OF HEALTH CARE

**РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ
REGISTRATION CERTIFICATE**

№ ФСЗ 2012/12627

от 22 августа 2012 года

Срок действия: не ограничен.

Настоящее удостоверение выдано
«Кирхнер энд Вильгельм ГмбХ + Ко. КГ», Германия,
Kirchner & Wilhelm GmbH + Co. KG, Eberhardstr. 56, 71679 Asperg, Germany
и подтверждает, что изделие медицинского назначения (изделие медицинской
техники)

Ларингоскопы интубационные с принадлежностями
(см. Приложение на 1 листе)
производства

«Кирхнер энд Вильгельм ГмбХ + Ко. КГ», Германия,
Kirchner & Wilhelm GmbH + Co. KG, Eberhardstr. 56, 71679 Asperg, Germany

класс потенциального риска 2а

ОКП 94 4210

соответствующее комплекту регистрационной документации

КРД №17888 от 29.05.2012

приказом Росздравнадзора от 22 августа 2012 года №950-Пр/12

разрешено к импорту, продаже и применению на территории Российской
Федерации

Врио руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



Е.А. Тельнова

0000473

САНКТ-

КОПИЯ
С КОПИИ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

FEDERAL SERVICE OF HEALTH CARE

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
ATTACHMENT
№ ФСЗ 2012/12627**



Лист 1

I. Ларингоскопы интубационные:

1. Ларингоскоп со стандартной оптикой.
2. Ларингоскоп с волоконной оптикой.

II. Принадлежности:

1. Рукоять.
2. Клинок, тип «Макинтош».
3. Клинок, тип «Флеплайт» с изменяемой кривизной лезвия.
4. Клинок, тип «Миллер».
5. Клинок, тип «Фореджер».
6. Клинок, тип «Тепро».
7. Клинок, тип «Полио».
8. Лампа сменная.
9. Световод волоконный сменный.
10. Батарея питания сменная.
11. Аккумулятор сменный.
12. Зарядное устройство универсальное.
13. Футляр комплектовочный.
14. Сумочка.

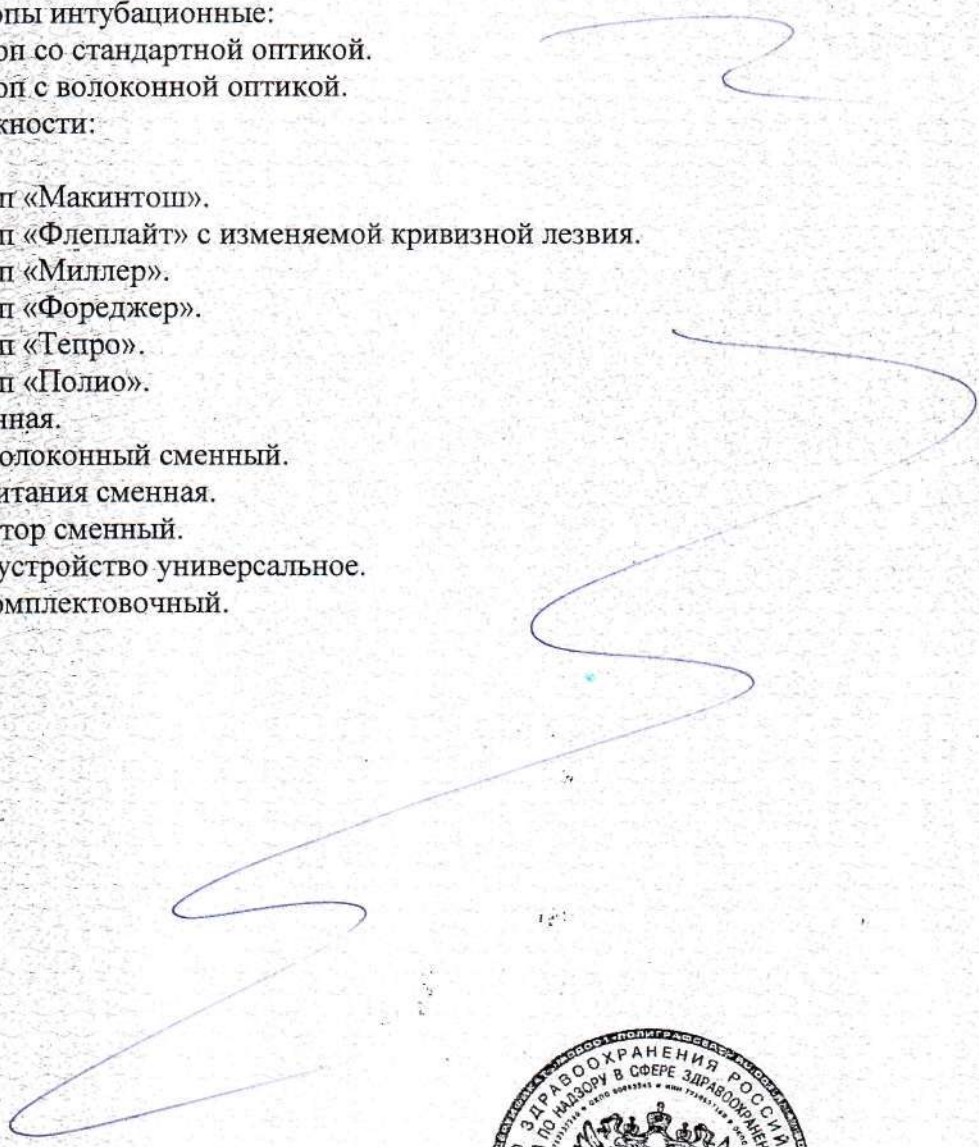

Врио руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



Е.А. Тельнова

22 августа 2012 года

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 000852